

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authorisation. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

A

besteht aus:

| | |
|---|-------------|
| 1 Stck Kabelbaum Sensoranschluss ge | 2M21678 |
| 1 Stck Kabelbaum Sensoranschluss ws | 2M21944 |
| 2 Stck Schraube | 1331930 |
| 1 Stck Blech | 2M21694 |
| 1 Stck Schraube | 1334689 |
| 1 Stck Kabel | 2M21770, ST |
| 1 Stck X Buchsl Geh Cri 1x7 LV00271 | 1817604 |
| 1 Stck X Buchsl Cod LV00127 | 1813536 |
| 6 Stck Kabelbinder | 8712007 |
| 1 Stck Schild | 2M21767 |
| 1 Stck Kreuzhalter | 8404154 |
| 1 Stck Rohrkern DI 8 LV00861 | 1825704 |
| 2 Stck Schraube | 1341227 |
| * 1 Stck Broschuere Thermo Mon. SD 6141.601 | ⑥ 9097387 |
| * 1 Stck Broschuere Thermo Mon. SD 6141.601 | ⑥ 9097384 |

D

* eingelegt in:


1 Stck Schutzhuelle ⑥ M22532 STM02884

verpackt in:

Flachbeutel mind. 240x300 DWN 1210

Einbau gemaesz FRO0053
oder FRO0054
oder FRO0083

ST2M21733



E

| scale | general tolerances | material | safety class |
|-------|--------------------|----------|----------------|
| --- | --- | --- | <s> 0 <m> 0 |

| field reserved | revision text |
|----------------|---|
| | Zeichn.-Nr. nachgetragen (1998 / CC / 135) |

F




| filing dept. | responsible dept. | author | approved | contract |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 2530 | 3401 | date name | 03.06.1998 Stickel | 03.06.1998 Hartwig |
| type | language | title | number | page/of |
| drawing | de | Kabelbaum ThermoMonitoring | 2M21733 | 01/01 |
| creating system | release status | revision index | occures | Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck |
| CADRA | PROD | 06 | 3x | |

Dräger

Dräger Medizintechnik
GmbH,
D-23542 Lübeck

size A4

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

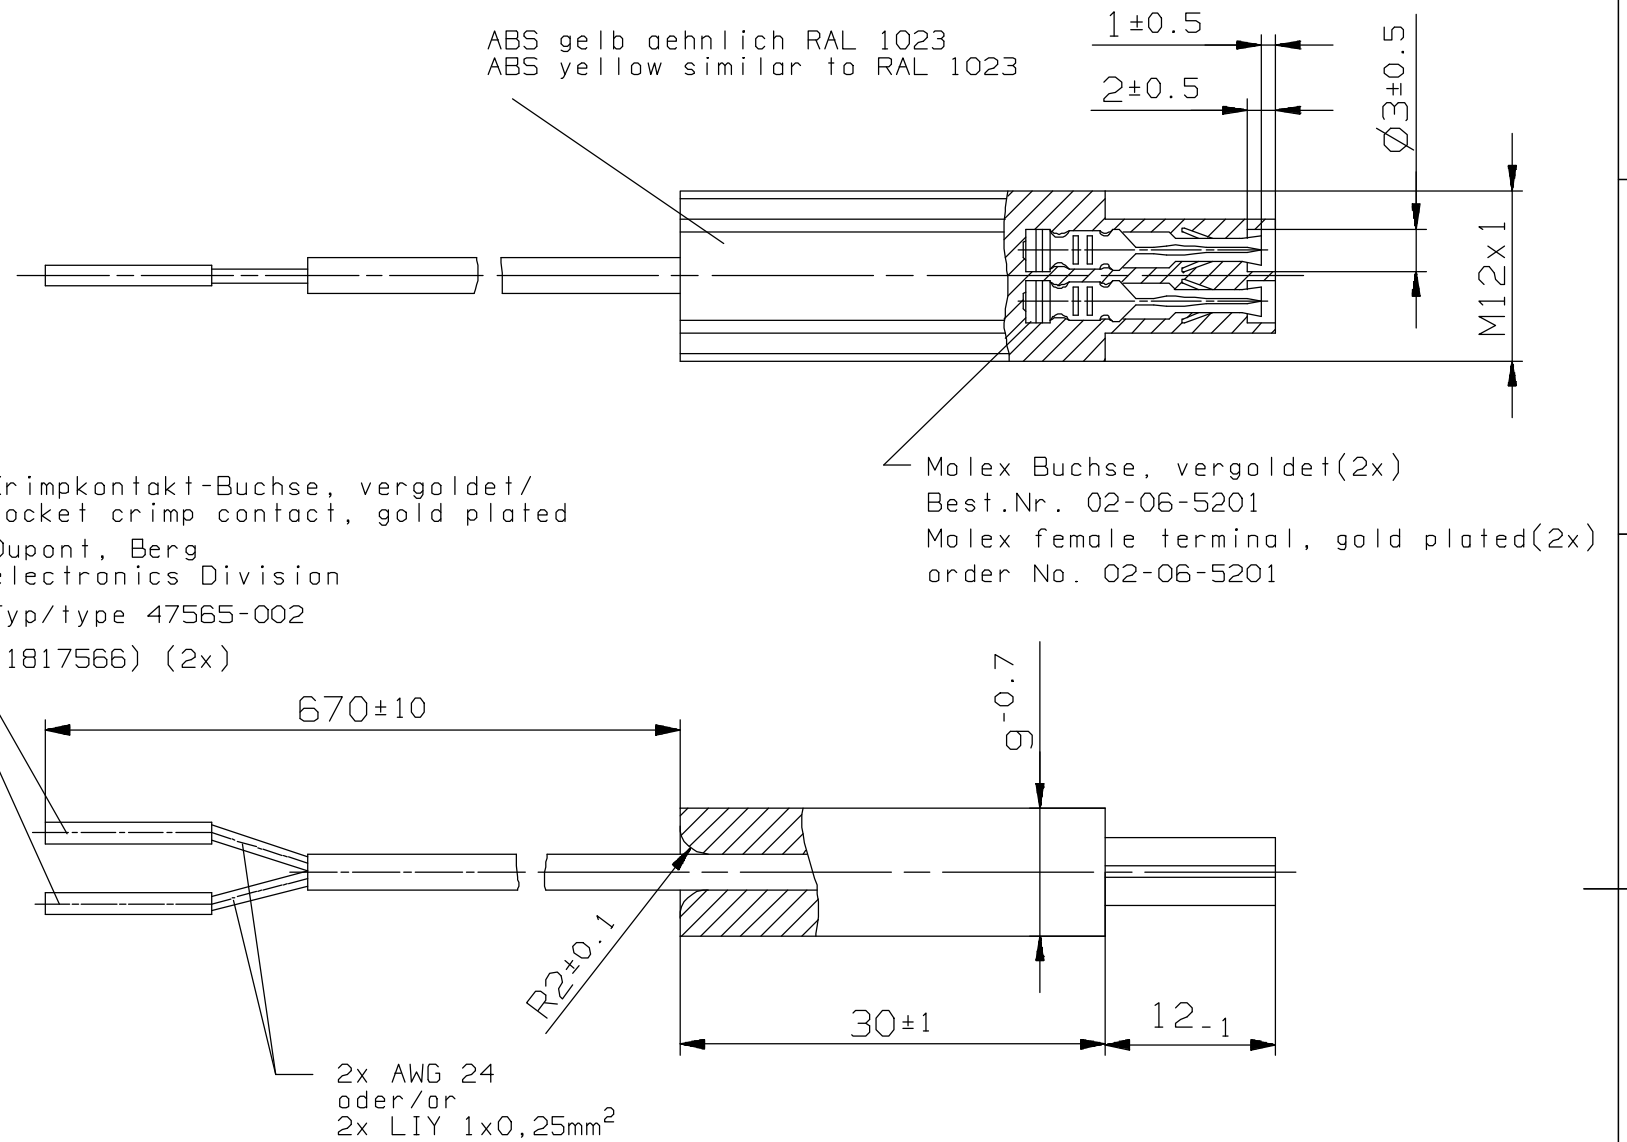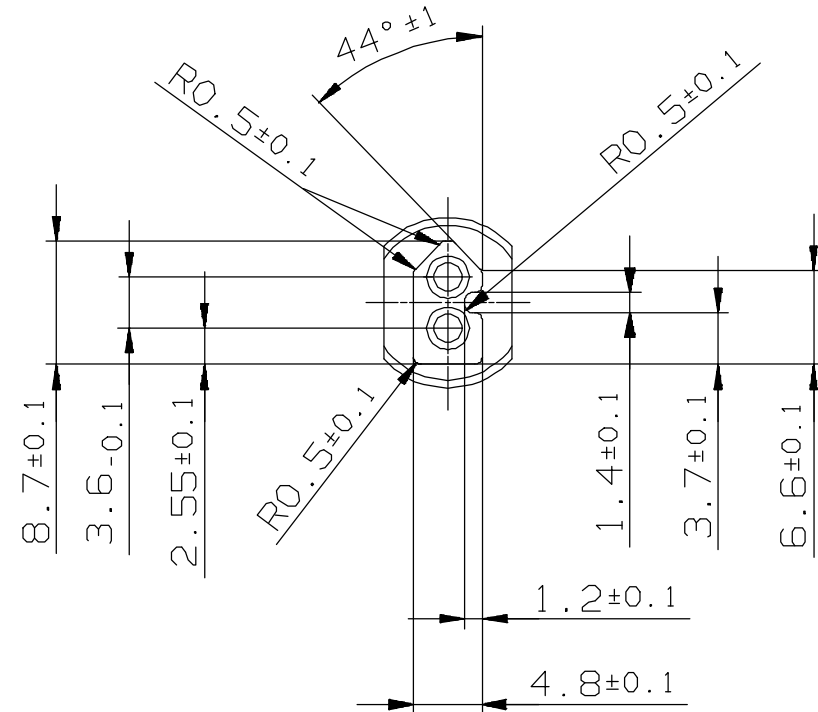

alle Abmessungen in mm

Farbe: gelb

Spannungsfestigkeit zwischen
den Steckkontakten: 500V

all dimensions in mm

colour: yellow

voltage stability between
contact pins: 500V





| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| scale 2:1 | general tolerances | material | safety class <s> 0 <m> 0 |
| field reserved | revision text neue Urzeichnung | (99 /MX / 10) | |
| filing dept 2950 | responsible dept. 5660 | author 28.05.1999 Bahrt | approved 28.05.1999 Conrad |
| type drawing | language de | title Kabelbaum Sensoranschluss ge | contract n |
| creating system CADRA | replacement for 2M21678-04 | number 2M21678 | revision index 05 |
| release status FREI | occures ox | page/of 01/01 | Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck |

Dräger

Dräger Medizintechnik
GmbH,
D-23542 Lübeck

size A3

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

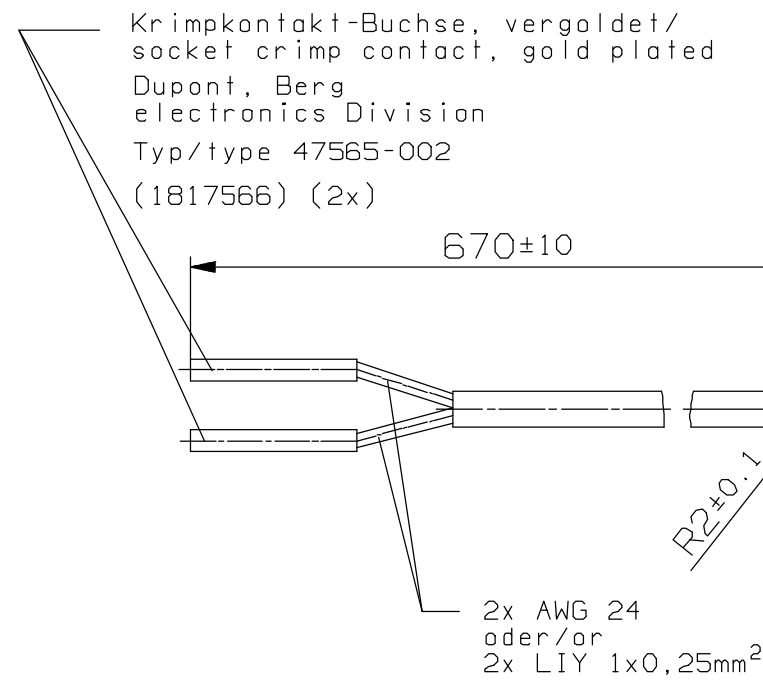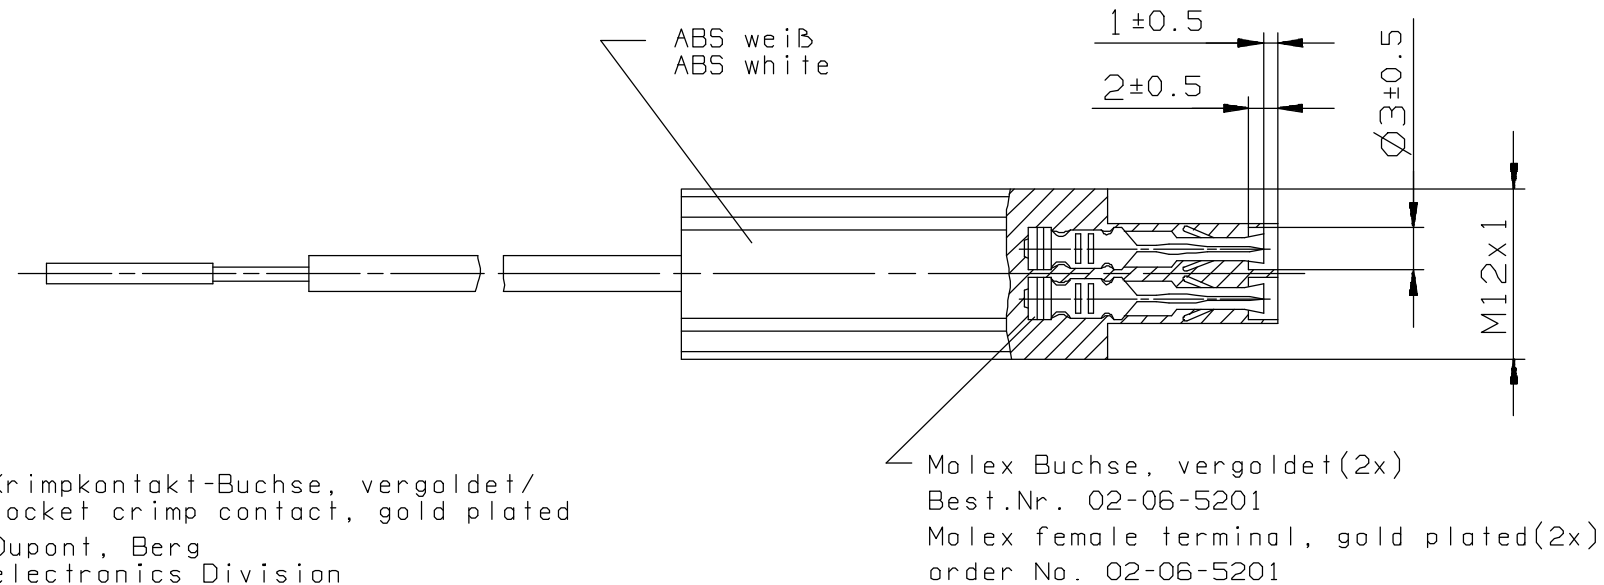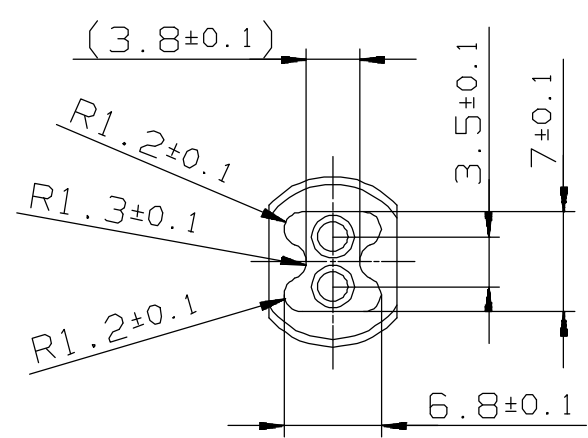

| | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------------|--|
| scale | general tolerances | material | safety class |
| 2:1 | | | <s> 0 <m> 0 |
| field reserved | | revision text | |
| | | neue Urzeichnung | |
| filing dept | responsible dept. | author | approved |
| 2950 | 5660 | 31.05.1999 | 31.05.1999 |
| | | date | |
| | | name | |
| | | Bahrt | Conrad |
| type | language | title | contract |
| drawing | de | Kabelbaum Sensoranschluss ws | n |
| | replacement for | number | |
| | 2M21944-03 | 2M21944 | |
| creating system | release status | revision index | occures |
| CADRA | FREI | 04 | ox |
| | | page/of | |
| | | 01/01 | |
| | | | Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck |

alle Abmessungen in mm
Farbe: weiß
Spannungsfestigkeit zwischen den Steckkontakten: 500V

all dimensions in mm
colour: white
voltage stability between contact pins: 500V



Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A3